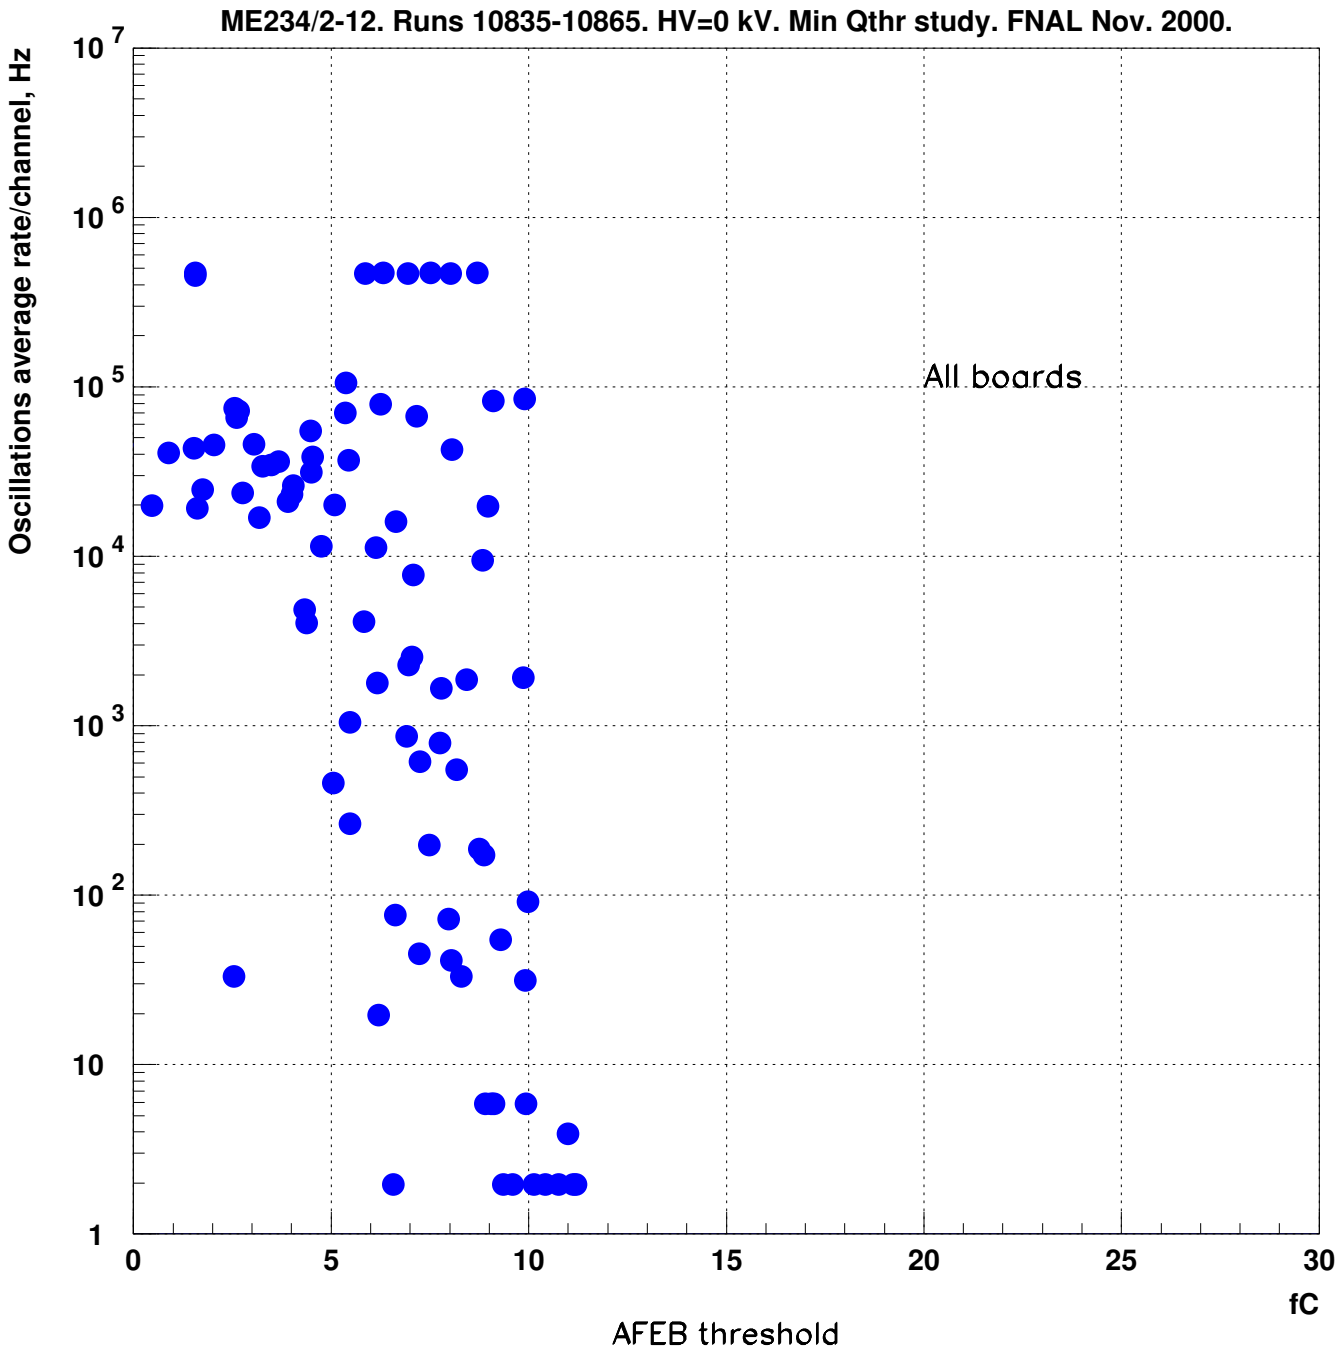
ME234/2-12. Runs 10835-10865. HV=0 kV. Min Qthr study. FNAL Nov. 2000.
Oscillations average rate/channel, Hz
All boards
AFEB threshold
fC
1
10
10 2
10 3
10 4
10 5
10 6
10 7
0
5
10
15
20
25
30