98/12/13 12.46

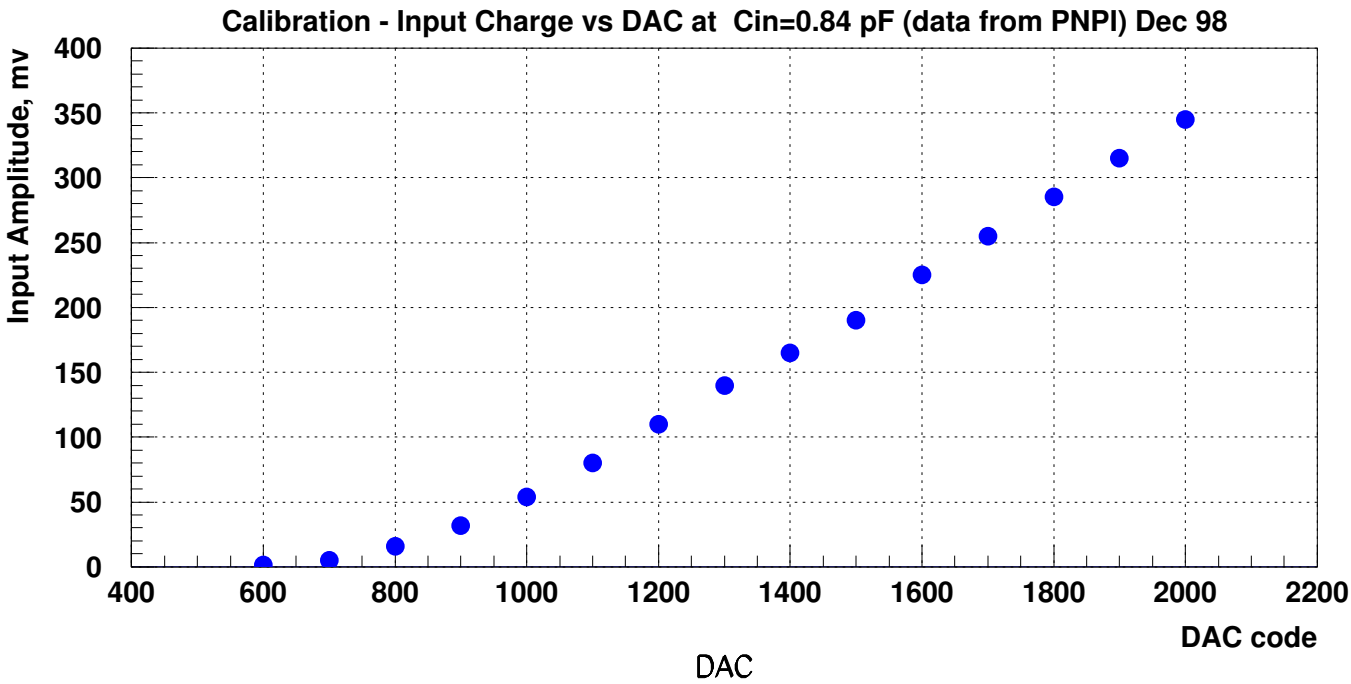
Calibration - Input Charge vs DAC at Cin=0.84 pF (data from PNPI) Dec 98
Input Amplitude, mv
400
350
300
250
200
150
100
50
0
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
DAC code
DAC

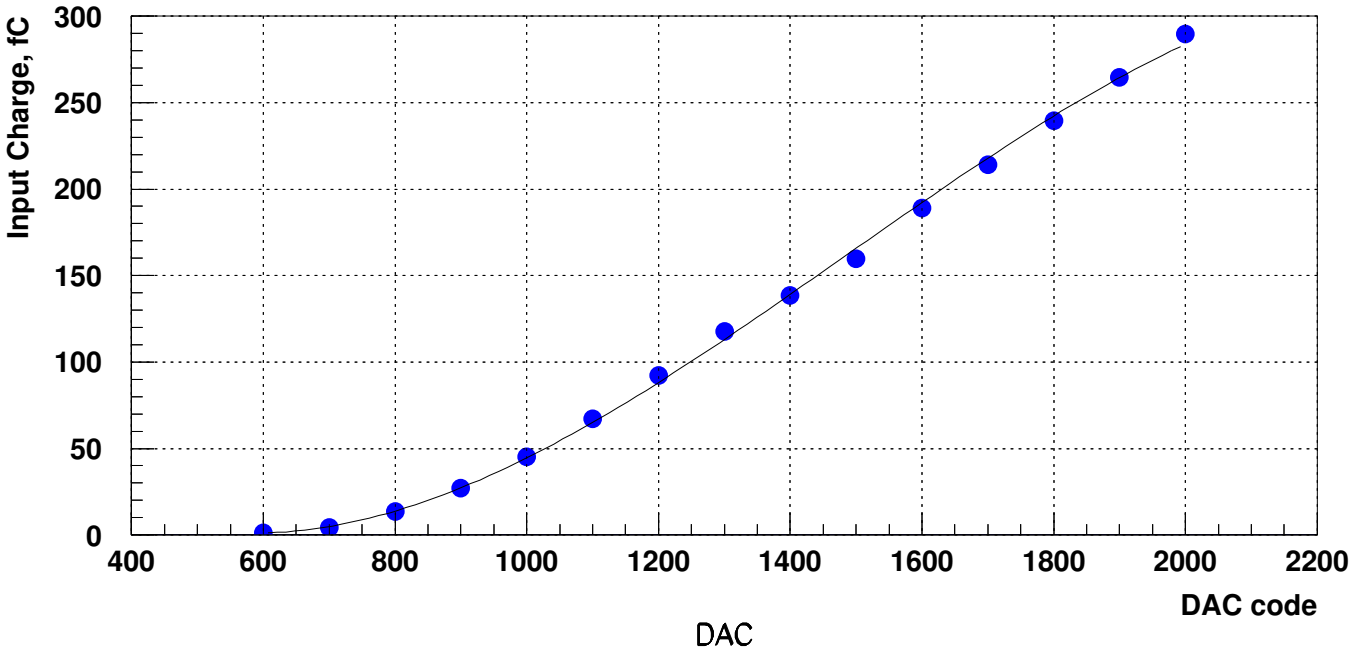
Input Charge, fC
300
250
200
150
100
50
0
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
DAC code
DAC